

Laboratuvar Kullanım Kılavuzu

1. Genel Özellikler

Laboratuvar modülü kurum içerisindeki personellerin tüm laboratuvar test tarihçesinin takibi için oluşturulmuştur. Tüm laboratuvar test işlemleri bu modülden yürütülür. Bu modüde oluşturulan ilgili testler muayene de çağırılabilir. Ayrıca modül çeşitli filtre yapısıyla Laboratuvar Test Liste Raporu sunar.

2. Yeni Laboratuvar Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Sağlığı menüsü altında Laboratuvar üzerine tıklanır.
- Daha önce oluşturulan laboratuvar kayıtları varsa listelenir.

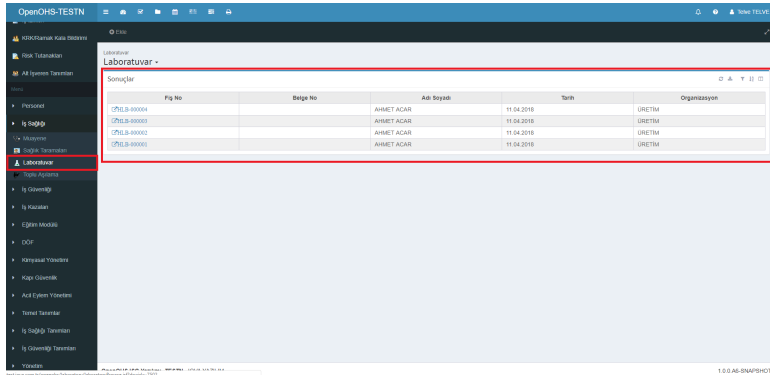


Fig No	Bolge No	Adı Soyadı	Tarih	Organizasyon
OTSLB-000004		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
OTSLB-000003		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
OTSLB-000002		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
OTSLB-000001		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM

- Yeni laboratuvar kaydı oluşturmak için Ek1e düğmesine tıklanır.


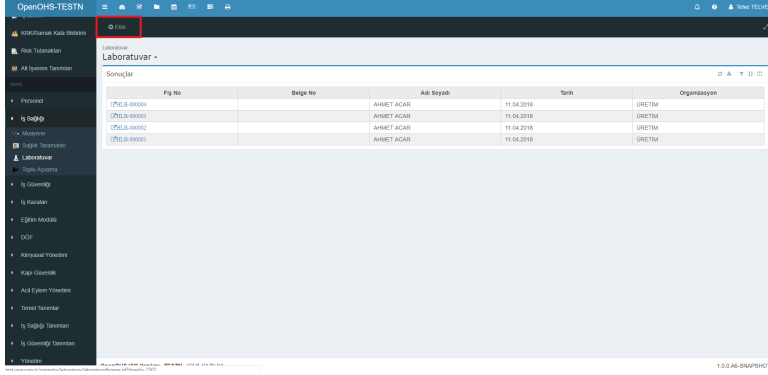


Fig No	Birge No	Adı Soyadı	Tarih	Organizasyon
CPILB-000004		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
CPILB-000003		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
CPILB-000002		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
CPILB-000001		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM

Figure 1. Yeni Laboratuvar Oluşturma

- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

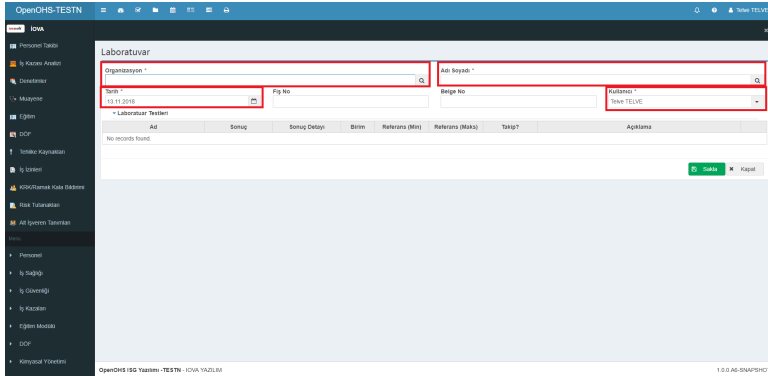

Adı	Soru	Soru Detayı	Birim	Referans (Min)	Referans (Max)	Takip?	Açıklama
No records found							



Sistemde personel Adı Soyadı alanı seçilirse Organizasyon alanını personelin bulunduğu organizasyona göre otomatik olarak gelir. Organizasyon ve Adı Soyadı alanı girildikten sonra Laboratuvar Testleri ekleme düğmesi görüntülenir.

- Laboratuvar test seçimi için Laboratuvar Testleri alanında yer alan artı düğmesine tıklanır.

Figure 2. Laboratuvar Testleri Ekleme

- Açılan sayfada eklenecek laboratuvar testleri arama çubuğuna yazılarak CTRL +Enter tuş takımıyla yada büyüteç yardımıyla aranır.
- Test Grubuna göre seçim yapılmak isteniyorsa açılır listeden ilgili grup seçilerek o gruba bağlı testler listelenir ve seçim yapılır.

Kod	Ad
PHLTD-000347	Flow Cytometry
PHLTD-000356	Intraselüler Antijenler
PHLTD-000379	(IGF -1)
PHLTD-000206	
PHLTD-000281	11 - Deoksikortizol
PHLTD-000298	17 - Hidroksi Progesteron
PHLTD-000297	17 - Ketosteroid
PHLTD-000078	24 Saatlik İdrarda Transferrin

Figure 3. Laboratuvar Testleri Seçme

- Listelenen ekrandan testin üstüne bir kere tıklanır.Sağ tarafta Seçilenler başlığı altında listelenir.
- Seçimleri silmek için çöp kutusu düğmesine tıklanır.
- Seçimleri kaydetmek için Tamam düğmesine tıklanır.

Laboratuvar Test Arama
✕

Ara

Q

Test Grubu

▼

☐ Sadece Favoriler

Toplam Seçim : 3 ✕

Kod	Ad
PHLTD-000347	Flow Cytometry
PHLTD-000356	Intraselüler Antijenler
PHLTD-000379	(IGF -1)
PHLTD-000206	
PHLTD-000281	11 - Deoksikortizol
PHLTD-000298	17 - Hidroksi Progesteron
PHLTD-000297	17 - Ketosteroid
PHLTD-000078	24 Saatlik İdrarda Transferrin

Seçilenler

Intraselüler Antijenler
 11 - Deoksikortizol
 17 - Hidroksi Progesteron

★ Favori

✓ Tamam

✕ Vazgeç

Figure 4. Laboratuvar Seçimlerini Kaydetme ve Silme

- Seçilen laboratuvar testleri listelenir.Sonuç detayları yazılır ve Sakla düğmesine tıklanır.

Laboratuvar
✕

Organizasyon

ORGANİZASYON ÖZETİMİ

Tarih : 15.11.2018

Fig No

Adı Soyadı : DR.İLHAN AKAR

Birlik No

Kullanıcı : TAYAN TELME

Laboratuvar Testleri

Ad	Sonuç	Sonuç Detayı	Birim	Referans (Biri)	Referans (Biri)	Tekrar?	Açıklama
Intraselüler Antijenler							
11 - Deoksikortizol	Negatif						
17 - Hidroksi Progesteron							

Sakla
Kapat

3. Laboratuvar Listeleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Sağlığı menüsü altında Laboratuvar üzerine tıklanır.
- Daha önce oluşturulan laboratuvar kayıtları varsa listelenir.

Fiş No	Denge No	Adı Soyadı	Tarih	Organizasyon
0701-B-00004		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
0701-B-00003		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
0701-B-00002		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
0701-B-00001		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM

Figure 5. Laboratuvar Listeleme

4. Laboratuvar Düzenleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Sağlığı menüsü altında Laboratuvar üzerine tıklanır.
- Daha önce oluşturulan laboratuvar kayıtları varsa listelenir.
- Düzenlenecek olan parametrenin Fiş No üzerindeki linkine tıklanır. Açılan ekranda düzenleme yapılacak parametre bilgileri gelir.

Fiş No	Denge No	Adı Soyadı	Tarih	Organizasyon
0701-B-00001		AHMET ACAR	10.11.2018	URETİM
0701-B-00004		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
0701-B-00003		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
0701-B-00002		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM
0701-B-00001		AHMET ACAR	11.04.2018	URETİM

- Sağ alt tarafta bulunan Düzenle düğmesine tıklanır.

OpenOHS-TESTN

Laboratuvar HLB-000003

Ad Soyadı: AHMET ACAR
Tarih: 13.11.2018
Fiş No: HLB-000003

Organizasyon: [PCO-000000] ÜRETİM
Bilgi No: [PCO-000000] ÜRETİM
Kullanıcı: Telen TELVE

Ad	Sonuç	Sonuç Değeri	Birim	Referans (Min)	Referans (Max)	Takip?	Açıklama
Hepatitiz Antijenler						Evet	
H1 - Hepatitiz Antijenleri	Negatif					Hayır	
H2 - Hepatitiz Profili						Evet	

Düzenle Kapat

OpenOHS ISO Yaşamın TESTN - İÇİN YAZILMIŞ 1.0.0 AG-EMPHOT

- Düzenlenmek istenen alanlar değiştirildikten sonra sakla düğmesine tıklanır. Düzenlenmiş hali ile kaydedilir.

OpenOHS-TESTN

Laboratuvar HLB-000003

Ad Soyadı: AHMET ACAR
Tarih: 13.11.2018
Fiş No: HLB-000003

Organizasyon: [PCO-000000] ÜRETİM
Bilgi No: [PCO-000000] ÜRETİM
Kullanıcı: Telen TELVE

Ad	Sonuç	Sonuç Değeri	Birim	Referans (Min)	Referans (Max)	Takip?	Açıklama
Hepatitiz Antijenler						✓	Hepatitiz Antijenleri
H1 - Hepatitiz Antijenleri	Negatif					✓	
H2 - Hepatitiz Profili						✓	

Düzenle Kapat

OpenOHS ISO Yaşamın TESTN - İÇİN YAZILMIŞ 1.0.0 AG-EMPHOT

Figure 6. Örnek Laboratuvar Düzenleme

5. Laboratuvar Silme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Sağlığı menüsü altında Laboratuvar üzerine tıklanır.
- Daha önce oluşturulan laboratuvar kayıtları varsa listelenir.
- Silinmek istenen parametrenin Fiş No üzerindeki linkine tıklanır.
- Açılan ekranda silme yapılacak parametre bilgileri gelir.
- Sağ alt tarafta bulunan Düzenle düğmesine tıklanır.
- Sağ alt tarafta yer alan Sil düğmesine tıklanır.

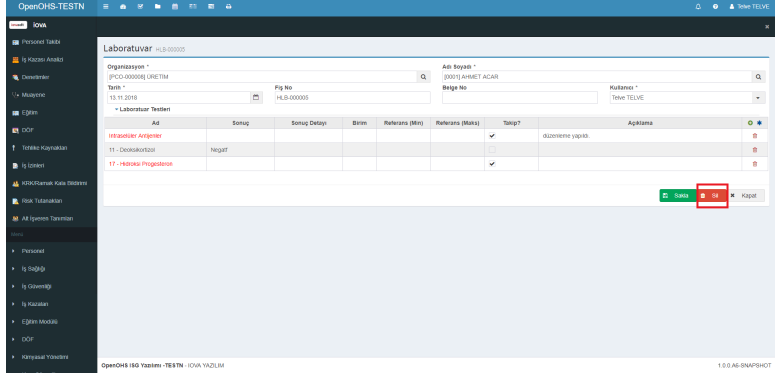


Figure 7. Örnek Laboratuvar Silme

- Sil butonuna tıklandığında sistem kullanıcıya parametreyi silmek istediğinden emin olmak için bir onay kutusu yөнeltir.
- Evet düğmesine tıklandığında silinmek istenilen laboratuvar silinir.

